

Прилад для визначення густоти
цементного розчину ПГР

Паспорт
ГОСТ 5802-86

2020 р

1. Призначення:

1.1 Прилад для визначення густоти цементного розчину за ДСТУ Б В.2.7-239: 2010, (EN 1015-11: 1999, NEQ), (ГОСТ 5802-86


2. Технічні характеристики:

Розмір 286x230x760 мм

Ц. поділки-1 мм

Вага стержня 3 00+2 г

Кут конуса $30^{\circ}+30'$

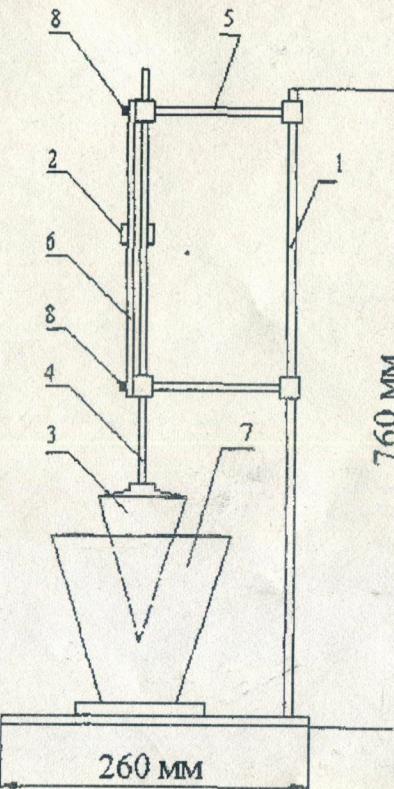

1 – штатив; 2 – шкала; 3 – еталонний конус; 4 – штанга; 5 – тимач; 6 – спрямувальні елементи; 7 – посуд для розчинової суміші; 8 – стопорний гвинт

3. ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

3.1. Прилад для визначення густини ПГР в пакованні підприємства-виробника може транспортуватись всіма видами критого транспорту у відповідності з правилами перевезення вантажів, що діють на кожному конкретному виді транспорту.

3.2. Умови транспортування і зберігання в транспортній тарі підприємства - виробника: температура навколошнього повітря від мінус 50 до 50° С; відносна вологість до 98 % за температури 25° С

4. ГАРАНТІЙ ВИРОБНИКА

4.1. Виробник гарантує відповідність приладу вимогам цих ТУ при дотриманні умов транспортування, зберігання та експлуатування.

4.2. Гарантійний термін експлуатації - 12 місяців від дня впровадження в експлуатування, але не пізніше 18 місяців від дня виготовлення.

5. СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

5.1. Свідоцтво про приймання

На підставі результатів приймально-здавальних випробувань прилад для визначення рухомості N _____ визнаний таким, що відповідає ГОСТ 5802-86 і придатним до застосування.

Представник ВТК _____

20.2.0.

Назва торгівельної організації _____

